



Simtec

Simulation et Mesure d'une sonde pour le contrôle d'un appareil de régulation pH, redox ou TDS (mesure de taux de sel et température)

Mode d'emploi _____

édition

07112024

Précautions d'usage

Sécurité

- Le Simtec possède une batterie rechargeable que ne devra être remplacée en fin de vie que par nos soins.
- Si du liquide ou un objet quelconque venait à pénétrer dans le boîtier, comme pour tout dysfonctionnement veuillez contacter notre service SAV.
- Interdiction de démonter l'appareil sans y avoir été invité par Régul Electronique au risque de perdre la garantie.

Conseils

Le Simtec est un appareil électrique qui ne doit être exposé ni à la pluie ni à l'humidité.

Le Simtec est un appareil portable, attention, des accidents de manipulation peuvent occasionner des dommages irréversibles, chutes immersions...

Il est livré dans une mallette veuillez à l'y remettre après son utilisation. .



- Vous venez d'acquérir un appareil de Régul'Electronique, nous vous remercions de votre confiance.

- A moins d'une spécification particulière, la garantie de nos appareils est de 3 ans à compter de la date de votre facture.

La sonde de niveau est garantie un an.

Sont exclues de la garantie toutes pièces d'usure (batteries)

- Cette garantie est limitée aux fournitures de notre Société. Elle consiste en la réparation, par nos soins et en nos ateliers, des vices de fabrication et de matière, que le client devra prouver.

- Le matériel devra nous être retourné Franco de port. Les frais de dépose et repose sont exclus de la garantie.

- Dans tous les cas, notre responsabilité se limite au remplacement des pièces défectueuses, sans qu'aucune indemnité ou dommage et intérêt puissent être réclamés pour les dégâts matériels ou corporels causés.

- La garantie cesse lorsque nos matériels sont modifiés en dehors de nos ateliers.

- La garantie ne s'applique pas aux remplacements ni aux réparations qui résulteraient de l'usure normale de matériels, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'installation non conforme ou d'utilisation anormale des appareils.

- Dans les cas d'usage inadapté, notre responsabilité ne saurait être engagée, notamment en cas de corrosion, accrocs de peinture et défauts.

Réexpédition

Conserver le carton d'emballage original et le matériel d'emballage pour l'expédition de l'appareil.

Pour assurer une protection maximale, remballer l'appareil tel qu'il avait été emballé en usine.



www.regul.fr

Régul électronique conçoit et fabrique dans ses ateliers, en France, l'intégralité de ses produits d'électrolyse de sel, de régulation de pH et de régulation de niveau de l'eau.

Table des matières

Garantie et précaution d'usage 2

1 Emplacement des commandes 5

2 - Exemple de navigation 6

3 - Menu Fonction 7


4 - Fonction pH 8

5 - Fonction ORP 9

6 - Fonction TDS 10

7 - Paramètres 11

1- Emplacement des commandes

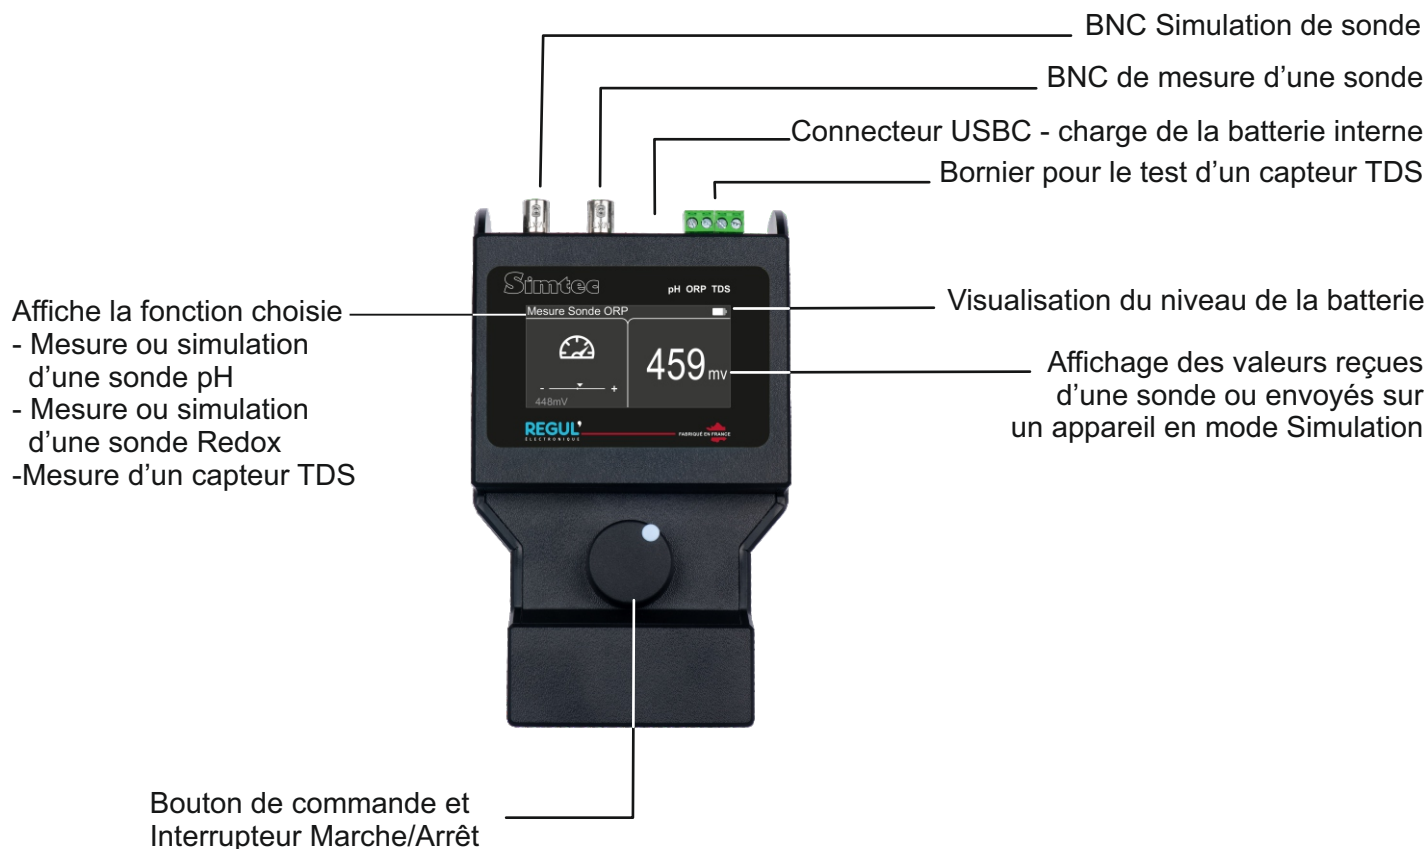

Conditionnement

Mallette de protection et de transport

5 flacons

- étalon pH 7.00
- étalon pH 4.01
- étalon ORP 4.75
- étalon TDS 12.88 μ S = 6.44ppt
- flacon de KCL


Cordon Double BNC male

Simtec


Simulation et Mesure de sonde pH redox et TDS
de régulations pH ORP et TDS pour
la mesure du sel dans l'eau de piscine
Non fourni : chargeur de batterie



2- Exemple de navigation

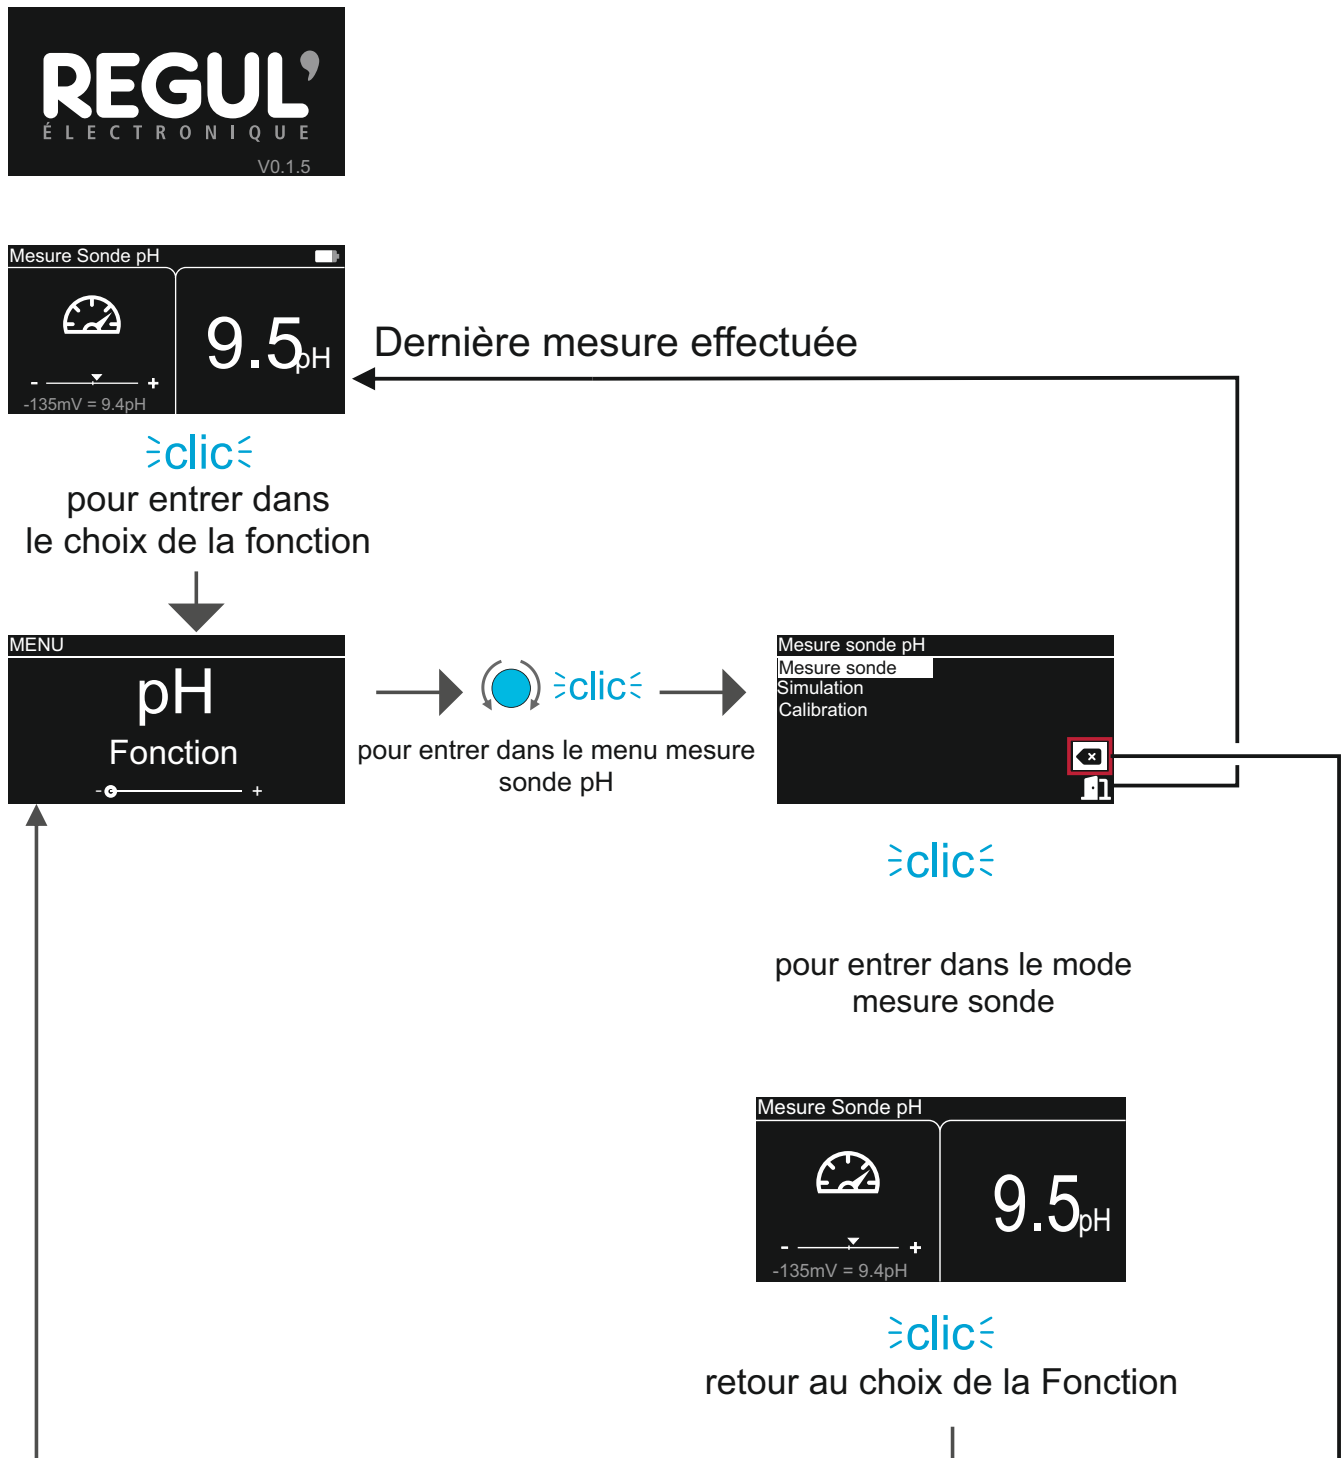


3 - Menu Fonction




Dernière mesure effectuée

≡clíc≡

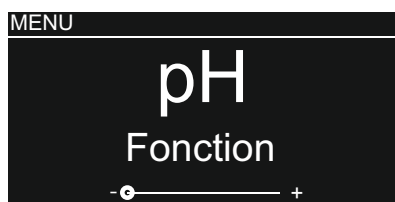

≡clíc≡

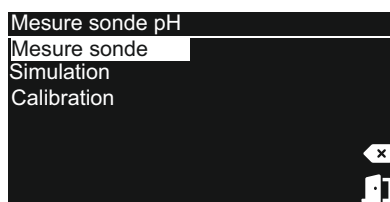

retour menu




dernière mesure


Choisir la ligne
puis valider

≡clíc≡

Voir page 8

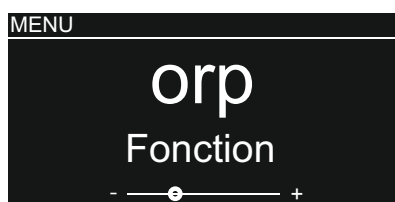

≡clíc≡

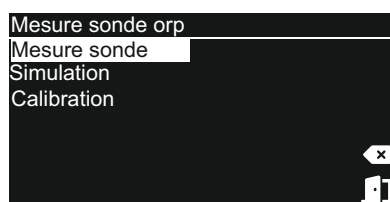

retour menu




dernière mesure


Choisir la ligne
puis valider

≡clíc≡

Voir page 9

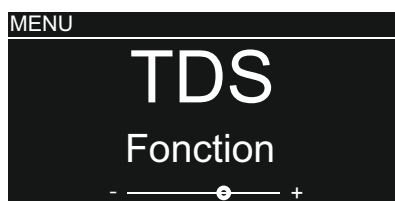

≡clíc≡

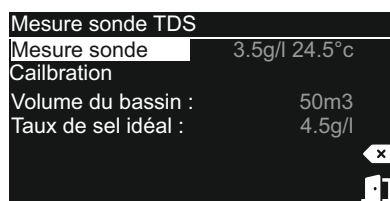

retour menu




dernière mesure


Choisir la ligne
puis valider

≡clíc≡

Voir page 10

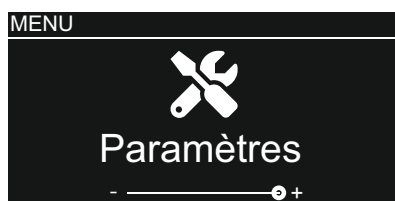

≡clíc≡

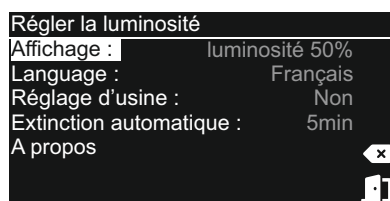

retour menu



dernière mesure

Choisir la ligne
puis valider

≡clíc≡

Voir page 11

4 - Fonction pH

mode Mesure : Connecter la BNC de la sonde à tester sur le Simtec.

mode Simulation : Connecter le câble BNC/BNC fourni entre le Simtec et l'appareil à tester.

mode Calibration : permet de calibrer le Simtec avec votre sonde de référence (pH ,redox et TDS). Vous pourrez effectuer un contrôle rapide l'état d'une piscine en mesurant pH, redox et TDS




5 - Fonction ORP - redox

mode Mesure : Connecter la BNC de la sonde à tester sur le Simtec.

mode Simulation : Connecter le câble BNC/BNC fourni entre le Simtec et l'appareil à tester.


mode Calibration : permet de calibrer le Simtec avec votre sonde de référence (pH ,redox et TDS). Vous pourrez effectuer un contrôle rapide l'état d'une piscine en mesurant pH, redox et TDS

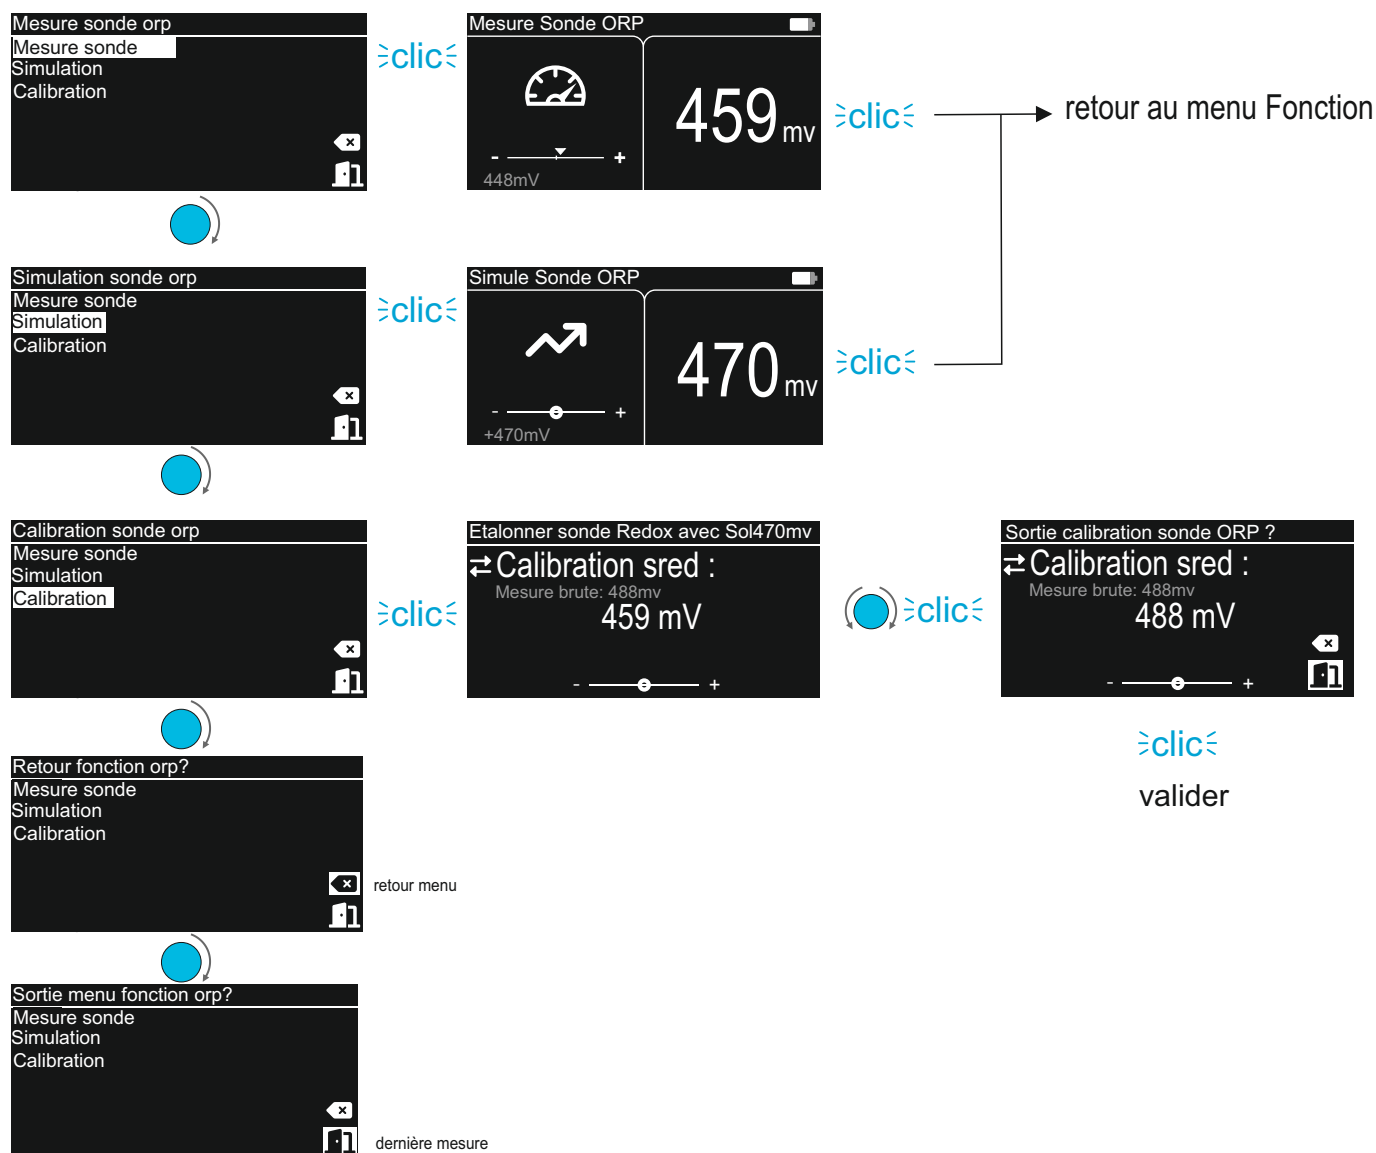

6 - Fonction TDS

mode Mesure ou calibration : Connecter le capteur TDS sur le Simtec sur le bornier 4pts.

mode Calibration : permet de calibrer le Simtec avec votre sonde de référence (pH ,redox et TDS). Vous pourrez effectuer un contrôle rapide l'état d'une piscine en mesurant pH, redox et TDS

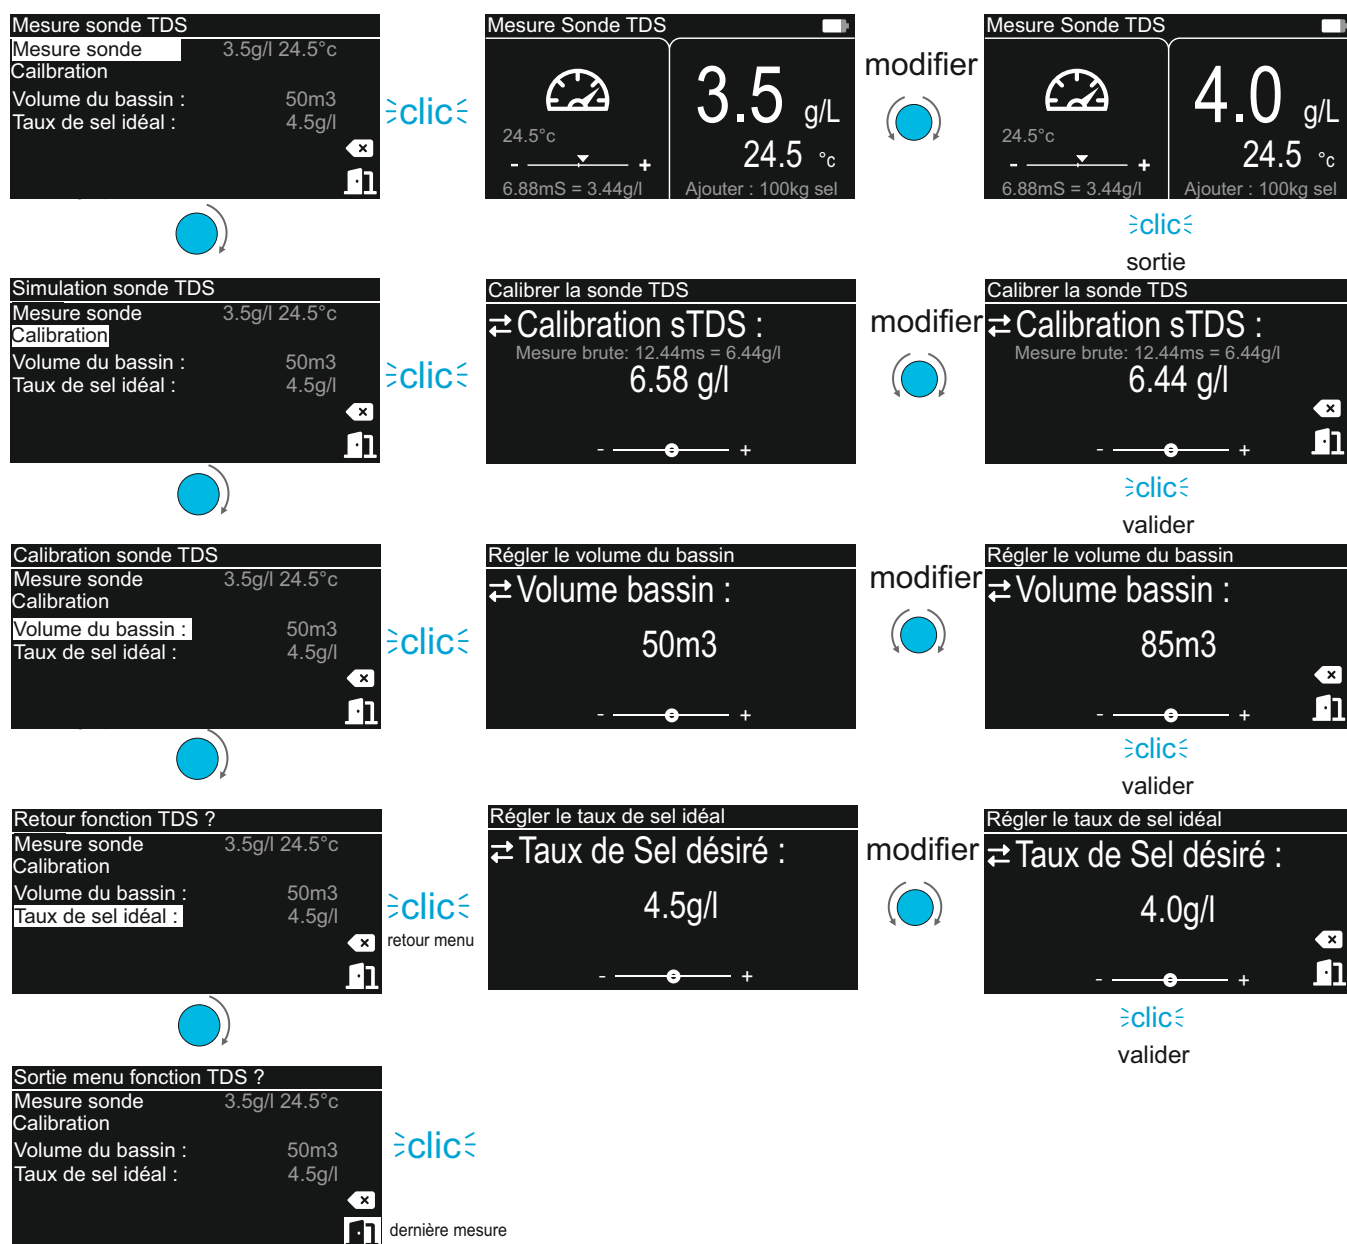

7- Paramètres

Luminosité de l'écran: réglable de 0 à 100% (50% conseillé max pour l'autonomie de la batterie)

Langues: Français, Anglais...

Réglage d'usine:

Extinction auto: Arrêt automatique après 1 à 10mn ou non

A propos: Version firmware:


Version hardware:

Date:

Numéro de série:

Batterie:



Temp. batterie:

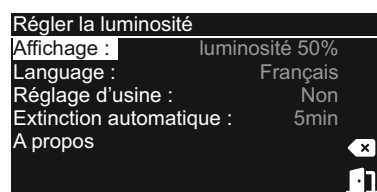

≡clique≡




5 à 100

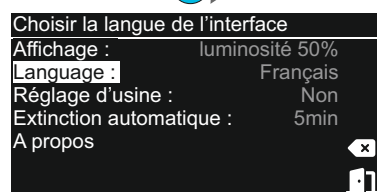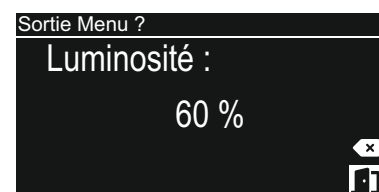


≡clique≡





Français
English
...

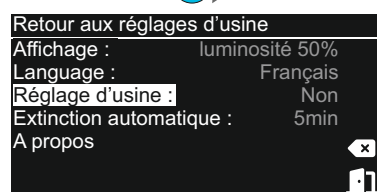


≡clique≡

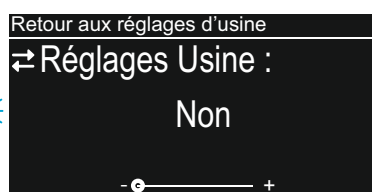



retour au
réglage
d'origine

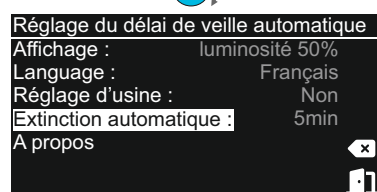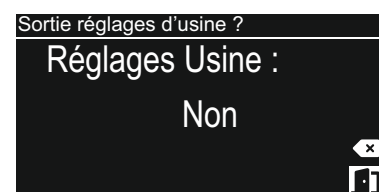



≡clique≡

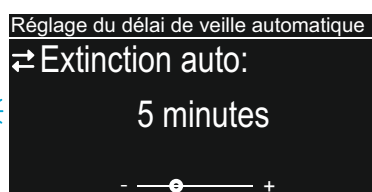

NON
1 à 10mn

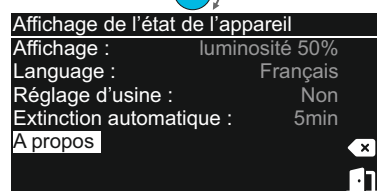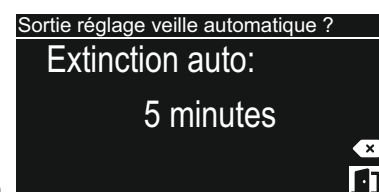

≡clique≡

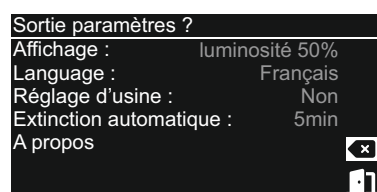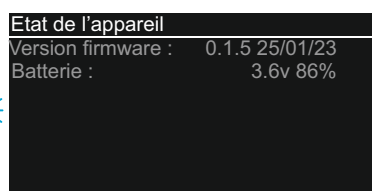

≡clique≡

Sortie paramètres

REGUL'
ÉLECTRONIQUE

